


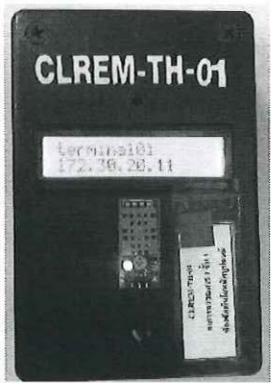

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บัญชีรายชื่อและประวัติเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ/ อุปกรณ์วัด	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลข เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง (อาคาร ชั้น ห้อง)	ตัวแทนจำหน่าย	บันทึกความเสียหาย ความผิดปกติ การดัดแปลงหรือการซ่อมแซม	หมายเหตุ
1.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-01	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 1 ห้องจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์	-		
2.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-02	อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 1 ห้อง Bookstore	-		
3.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-03	อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 1 ห้องเก็บวัสดุ งานผลิตเอกสารกลาง	-		
4.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-04	อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติงาน งานผลิตเอกสารกลาง	-		
5.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-05	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 1 ห้อง Server	-		
6.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-06	อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 3 ห้อง Server	-		
7.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-07	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสือหมวด A-P No.21	-		
8.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-08	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสือหมวด A-P No.34	-		
9.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-09	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง	-		
10.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-10	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสือหมวด Q-Z No.33	-		
11.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-11	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสือหมวด Q-Z No.48	-		
12.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-12	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์	-		
13.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-13	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 3 บริเวณชั้นวารสารภาษาไทย	-		
14.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-14	อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 3 บริเวณห้อง Journal	-		
15.	Thermo-Hygrometer	-	CLREM-TH-15	อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 3 บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือหน้าห้องค้นคว้า	-		
รูปภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด					คุณสมบัติ	- ช่วงการวัด Temperature: 0 to 50°C ความผิดพลาด +2 - Humidity: 20 to 80 % ความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน 5%	

ลงชื่อ.....

(นายสุราษฎร์...เยี่ยมคุณมงคล)

ตำแหน่ง.....นักเทคโนโลยีการศึกษา.....

วันที่ 31 / 1.1. / 2567